



# 預防感染

您孩子使用的中心導管 (Broviac®、Port-a-Cath®、PICC)



當細菌或微生物從您孩子使用的中心導管進入血液時，就會出現血流感染。  
如果微生物進入血流，則孩子可能會生重病。

擔心您孩子使用的中心導管遭到感染時：

- 體溫高於100.4°時或根據醫生指示，電話聯繫您的醫生。
- 請勿服用Tylenol®或Motrin®，除非您的醫生指示您這麼做。
- 如果中心導管周圍的皮膚發紅、腫脹、流出液體、有氣味或疼痛，請立即打電話  
( ) \_\_\_\_\_

為了預防感染：

- 請向醫務人員出示「我的生命導管」卡。
- 保持敷料和導管的所有部份乾燥和清潔。
- 在碰觸導管前使用肥皂和水，或酒精性潔手液洗手。
- 確保家人和朋友在探訪前後洗手。
- 請勿讓任何人保養中心導管，除非他受過相關培訓。
- 更換中心導管敷料或注射帽時，請戴口罩。
- 始終使用所有用品的乾淨面。

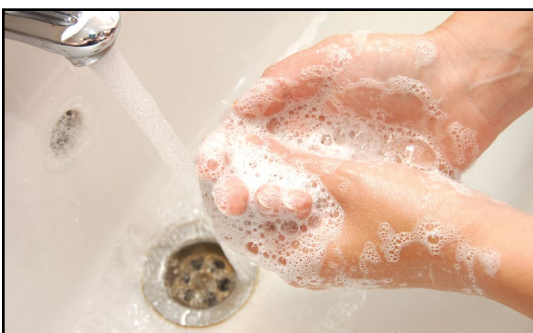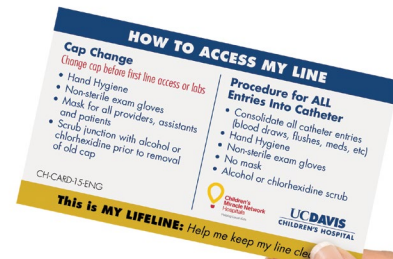

您可以說：「請洗手！」或者「你洗手了嗎？」

- 如果敷料變濕、變髒或出現任何類型的漏液或開始脫落，請更換。
- 在蓋上新敷料之前，敷料下的皮膚和任何導管部份都應當用洗必泰 (Chlorhexidine®) 大力擦洗。記住要讓它們完全乾燥。
- 請勿在清潔後吹皮膚或用手搨皮膚。
- 對於植入式導管 (Port-A-Caths®)、PICC，要使用藥盤 (BioPatch®)
- 在中心靜脈導管 (Broviac®) 上使用生產不超過一週的BIOPATCH®。
- 注射帽和連接處應當用酒精擦洗，並且完全乾燥。這兩個步驟都是必要的 (要求您的醫護人員進行處理)。
- 保持敷料和導管管路的所有部份乾燥和清潔。
- 請勿讓中心導管垂在浴盆裡、您孩子的尿布裡或掉在地上。

用品

- 將用品保存在清潔乾燥的地方。
- 讓用品遠離兒童或寵物。
- 若用品的包裝已打開或掉在地上，請勿使用。
- 請勿重複使用注射器或針頭。

欲獲得本書的額外副本，請在[children.ucdavis.edu](http://children.ucdavis.edu)訪問患者和家庭教育A-Z

**UC DAVIS**  
CHILDREN'S HOSPITAL

Children's Miracle Network Hospitals partner 